


Koherenční spektra přístroje Somavedic Atlantik  
**Srovnání zkušebního vzorku a reference při (-) cirkulační polarizaci**

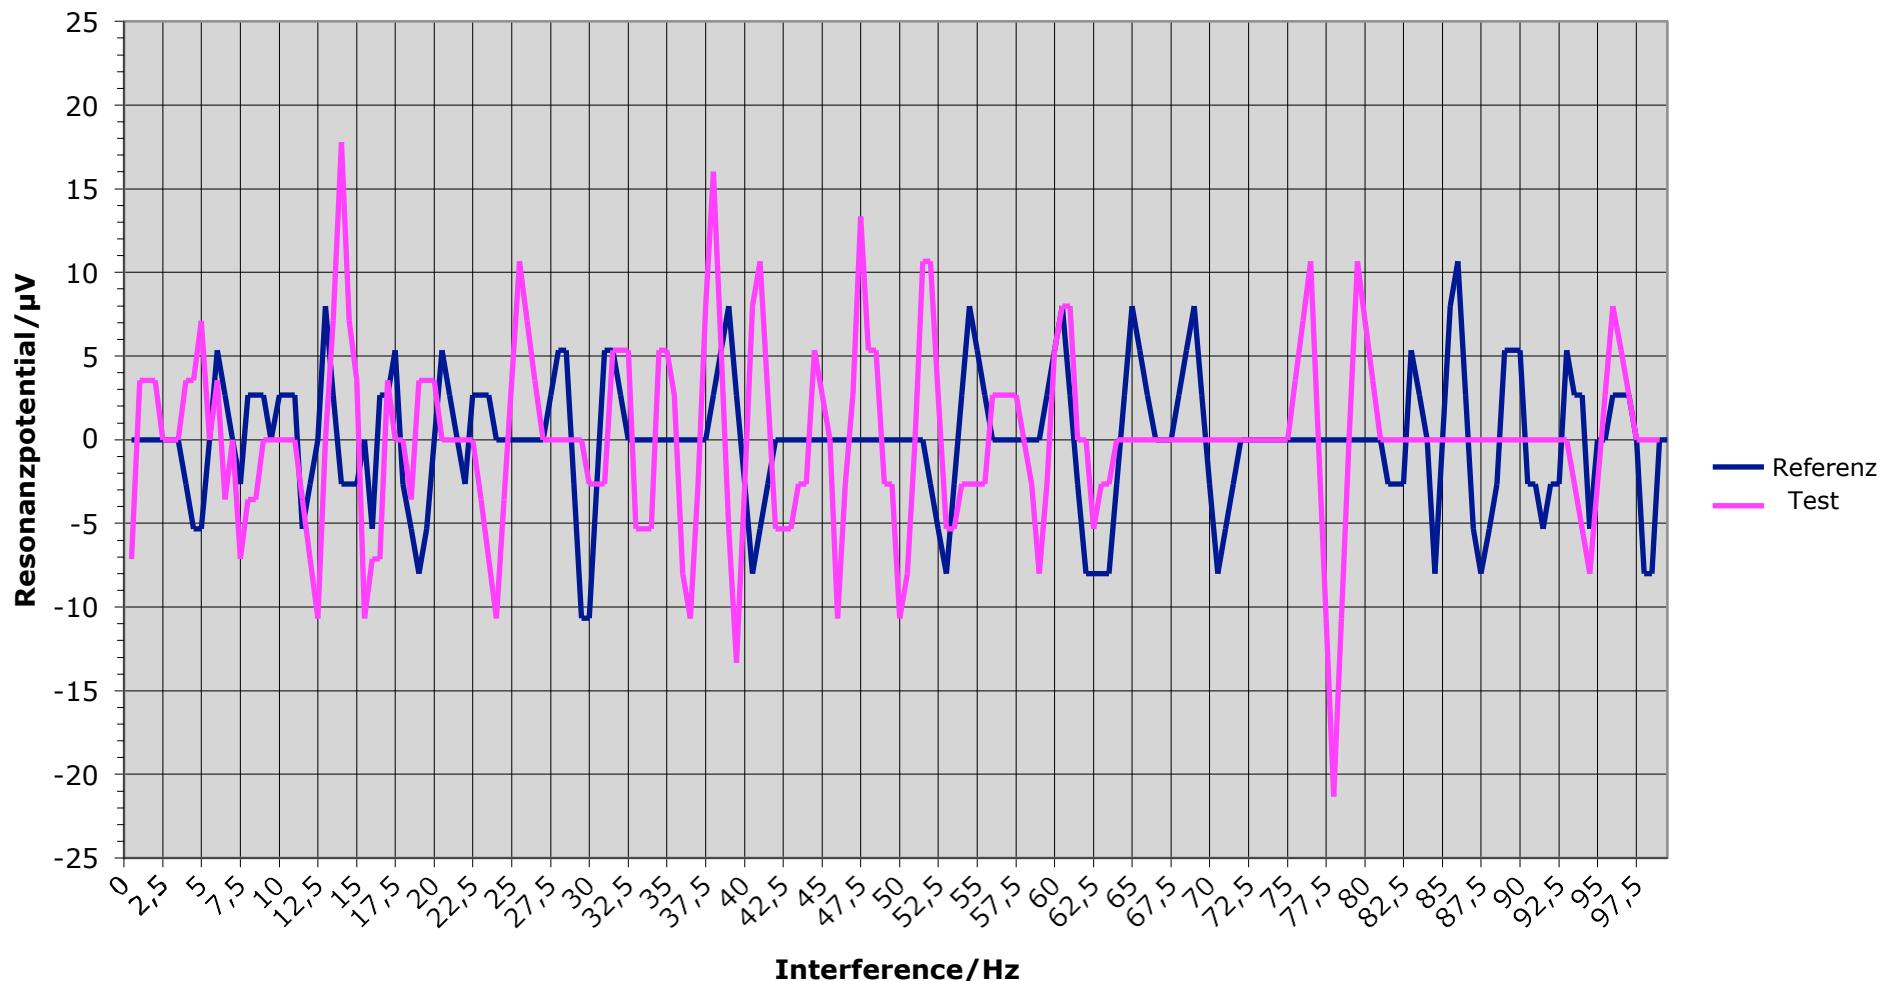

Resonanzpotential – rezonanční potenciál  
Referenz – referenční vzorek  
Test – zkušební vzorek